

Avance con confianza

Al finalizar el programa, se sentirá preparado para manejar su diabetes de una forma completamente nueva.

89% se siente más seguro en el manejo de la diabetes¹

90% entiende mejor el impacto de los alimentos en su nivel de glucosa¹




El sensor es resistente al agua hasta 1 metro (3 pies) de profundidad. No lo sumerja durante más de 30 minutos.

Referencia: 1. Datos en archivo. Abbott Diabetes Care.

COMIENCE A UTILIZAR:

MyFreeStyle

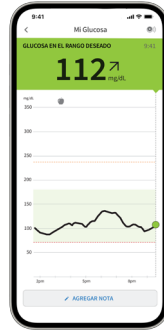

Únase al programa MyFreeStyle

ComenzarFreeStyle.us

FreeStyle



La finalidad de las imágenes de los productos es solo ilustrativa.

La cobertura de Medicare está disponible para el sistema FreeStyle Libre 2 si se utiliza el lector del sistema para revisar los datos de la glucosa algunos días de cada mes. Se aplican los criterios de Medicare y de otros terceros responsables de los pagos. Abbott proporciona esta información a modo de cortesía y está sujeta a cambios e interpretación. El cliente es el principal responsable de determinar los códigos, la cobertura y las políticas de pago correspondientes para pacientes individuales. Abbott no garantiza la cobertura ni el pago de nuestros productos por parte de terceros, ni reembolsa a los clientes reclamaciones denegadas por terceros responsables de los pagos.

Las aplicaciones FreeStyle LibreLink y FreeStyle Libre 2 solo son compatibles con determinados sistemas operativos y dispositivos móviles. Consulte nuestro sitio web para obtener más información sobre la compatibilidad de los dispositivos antes de utilizar la aplicación. El uso de las aplicaciones FreeStyle LibreLink o FreeStyle Libre 2 requiere el registro en LibreView.

Información de seguridad importante


Sistema FreeStyle Libre 2: Si no se utiliza el sistema FreeStyle Libre 2 según las instrucciones en la etiqueta, es posible que no se detecte un episodio grave de baja o alta glucosa en sangre o que se tome una decisión de tratamiento que pueda provocar una lesión. Si las alarmas y las lecturas de glucosa no coinciden con los síntomas o las expectativas, utilice un valor de glucosa en sangre obtenido mediante una punción en el dedo para tomar decisiones sobre el tratamiento. Busque atención médica cuando corresponda, comuníquese con Abbott llamando al 855-632-8658 o visite <https://www.FreeStyle.abbott/us-en/safety-information.html> para obtener información de seguridad.

La forma circular de la unidad del sensor, FreeStyle, Libre y las marcas relacionadas son propiedad de Abbott. Otras marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

©2022 Abbott. Todos los derechos reservados. ADC-56774 v1.0 06/22

COMIENCE A UTILIZAR:

MyFreeStyle

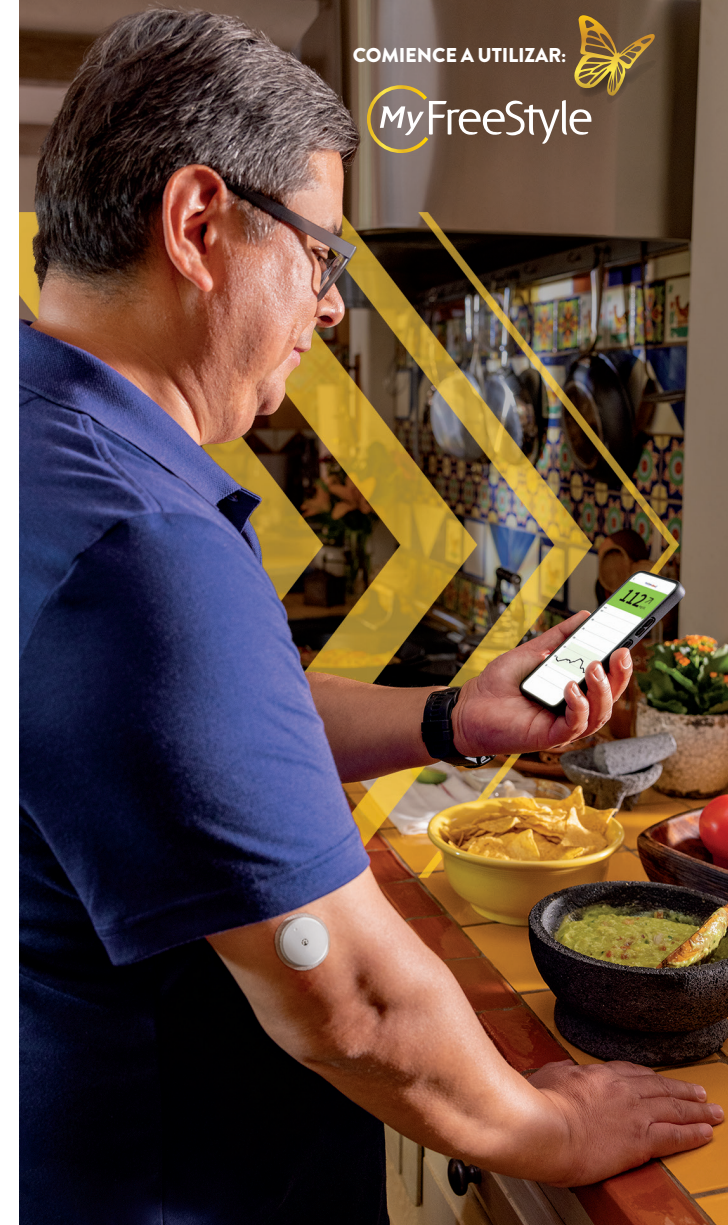


HAGA QUE LA DIABETES SEA MÁS FÁCIL DE MANEJAR

FreeStyle



Consulte la información de seguridad importante en el reverso del folleto.

COMIENCE UNA NUEVA ETAPA EN EL MANEJO DE LA DIABETES

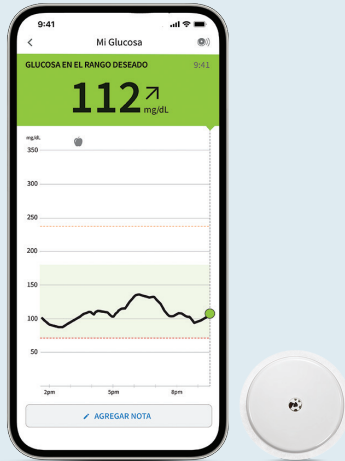

Comience a explorar la cartera de FreeStyle Libre

Sus niveles de glucosa dejarán de ser un misterio gracias a la cartera de sistemas de monitoreo continuo de la glucosa (CGM, por sus siglas en inglés) de FreeStyle Libre y sabrá qué afecta sus niveles de glucosa. Las lecturas incluyen su lectura de glucosa actual, una flecha de tendencia que indica la dirección de su nivel de glucosa y un gráfico que muestra su historial de glucosa durante las últimas 8 horas.

La cobertura de Medicare está disponible para el sistema FreeStyle Libre 2 si se utiliza el lector del sistema para revisar los datos de la glucosa algunos días de cada mes. Se aplican los criterios de Medicare y de otros terceros responsables de los pagos. Abbott proporciona esta información a modo de cortesía y está sujeta a cambios e interpretación. El cliente es el principal responsable de determinar los códigos, la cobertura y las políticas de pago correspondientes para pacientes individuales. Abbott no garantiza la cobertura ni el pago de nuestros productos por parte de terceros, ni reembolsa a los clientes reclamaciones denegadas por terceros responsables de los pagos.

Las aplicaciones FreeStyle LibreLink y FreeStyle Libre 2 solo son compatibles con determinados sistemas operativos y dispositivos móviles. Consulte nuestro sitio web para obtener más información sobre la compatibilidad de los dispositivos antes de utilizar la aplicación. El uso de las aplicaciones FreeStyle LibreLink o FreeStyle Libre 2 requiere el registro en LibreView.

El programa MyFreeStyle puede ayudarle a comenzar

Si participa en el programa MyFreeStyle, comprobará lo fácil que es aplicar,^{*1,2} activar y comenzar a escanear su sensor. También aprenderá la diferencia entre la lectura de glucosa del sensor y el valor de la glucosa en sangre.



Descubra cómo las pequeñas acciones pueden marcar una gran diferencia

Le mostraremos cómo utilizar la cartera de FreeStyle Libre para que maneje su diabetes de forma más personalizada. Recibirá información y correos electrónicos personalizados y adaptados a su experiencia para que sepa cómo los alimentos, el movimiento y el sueño afectan su nivel de glucosa.

Únase al programa MyFreeStyle hoy mismo

[ComenzarFreeStyle.us](https://www.abbott.com/MyFreeStyle)

*Los datos de este estudio se obtuvieron a través de la versión del sistema de 14 días FreeStyle Libre fuera de los EE. UU. El sistema FreeStyle Libre 2 tiene las mismas funciones que el sistema de 14 días FreeStyle Libre con alarmas de glucosa opcionales y en tiempo real. Por lo tanto, los datos del estudio se aplican a ambos productos.

Referencias: 1. Haak, T. Diabetes Therapy (2017): <https://doi.org/10.1007/s13300-016-0223-6>. 2. Campbell, F. Pediatric Diabetes (2018): <https://doi.org/10.1111/pedi.12735>.

Ponga en práctica lo que aprende

Durante el programa, también aprenderá a usar los informes de la cartera de FreeStyle Libre para entender mejor cómo funciona el cuerpo. Incluso vivirá experiencias reveladoras que puede usar para hacer cambios en su rutina de manejo de la diabetes.